


Drums

Gebrauchsanleitung



für
DocCheck "Tülip"
Littmann® Classic III™

Mein Verwendungszweck


Du möchtest dein Stethoskop in einen farbenfrohen Blickfang verwandeln? Dann ersetze die Standardmembran deines Stethoskops durch mich und schon hast du deinem Stethoskop ein modisches Update verpasst.

Bitte beachte, dass ich nicht für jedes Stethoskop geeignet bin. Benutze mich nur mit den auf der Verpackung angegebenen Stethoskop-Modellen.


Ungeeignete Anwendung

Wenn du mich anders anwendest als in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, entspricht das nicht meiner Bestimmung. Mein Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Anwendung resultieren. Das Risiko trägst in diesem Fall allein du, der Anwender. Also sei bitte vorsichtig!


Montage für "Tülip"




1. Löse den Ring, indem du ihn gegen die Uhrzeigerrichtung drehst.



2. Entnimm die alte Membran aus dem Verschlussring.




3. Lege mich so in den Ring, dass meine weiße Seite zu dir zeigt und ich flächig im Ring aufliege.




4. Drehe mich samt Verschluss fest an das Bruststück, so dass ich fest anliege und mein schönes Motiv dich anlacht.


Montage für Littmann Classic III




1. Entferne die alte Membran von deinem Stethoskop.




2. Nimm einen passenden Ring und drücke ihn ein paarmal in der Handfläche zusammen. Durch die Bewegung und die Wärme wird der Ring flexibler und die Montage einfacher.



3. Stecke mich jetzt zu ca. 1/4 in den Ring. Versuch nicht, mich gleich komplett in den Ring einzuspannen. Das könnte meinen sensiblen Körper beschädigen.



4. Halte mich nun zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe mich nach und nach in den Ring, indem du immer ein kleines Stück des Rings hochziehst und mich dort einrasten lässt, bis ich komplett im Ring stecke.



5. Nun kannst du mich wie gewohnt auf das Bruststück des Stethoskops montieren. Achte darauf, dass mein schönes Motiv nach oben zeigt.

Wenn ich bei Ankunft bereits im Ring stecke, beachte lediglich diesen Schritt.

Bitte teste die Funktionalität deines Stethoskops nach jedem Wechsel erneut!

Reinigung & Desinfektion

Reinige und desinfiziere mich regelmäßig. Das ist von großer Bedeutung – es dient sowohl dem Schutz des Patienten, des Anwenders und Dritter aber auch zum Erhalt meiner Qualität.

Ich vertrage ISO-Alkohol genauso wie herkömmliche Stethoskopmembranen auch. Reinige meine Oberfläche mit einem glatten Tuch, das du zuvor mit ISO-Alkohol

befeuchtest, um Staub und Verunreinigungen zu entfernen.

Trotz umfangreicher Maßnahmen meines Herstellers, die leuchtenden Farben meines Motivs zu erhalten, können Umwelteinflüsse dessen Langlebigkeit beeinflussen. Wechsle mich daher bitte nach 30 Tagen Benutzung aus oder wenn ich Verfärbungen oder Beschädigungen aufweise.

Gewährleistung

Wenn du mich bestimmungsgemäß benutzt und diese Gebrauchsanleitung beachtest, beträgt die Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler zwei Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum. Offenbarer Missbrauch und zufällige Beschädigungen sind davon ausgeschlossen. Kosmetische Schäden, wie Kratzer auf der Oberfläche sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Entsorgung


Entsorge mich bitte nur gemäß den lokalen/regionalen/internationalen Richtlinien.


Hersteller

DocCheck Shop GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Köln, Deutschland
doccheckshop.de


Littmann® und Classic III™ sind geschützte Marken der 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, USA und stehen in keinerlei Verbindung zur DocCheck Shop GmbH.

Symbolerklärung


 Medizinprodukt


 CE-Kennzeichen


 Herstellerdaten (Adresse)

 Produktionsdatum

 Artikelnummer


 Charge

 Kein Latex/Naturkautschuk enthalten

 Mein Held
doccheck.com

Copper

User Manual



for

DocCheck "Tülip"

Littmann® Classic III™

My intended use


You want to transform your stethoscope into a colorful eye-catcher? Then replace your standard membrane with me, and you'll give your stethoscope a stylish update.

Please note that I am not suitable for every stethoscope. Use me only with the stethoscope models listed on the packaging.


Unsuitable usage

If you use me differently than described in these instructions, in a way that does not correspond to my purpose, my manufacturer is not liable for damage(s) resulting from this improper use. In this case, you, the user, bear the risk. So be careful!


Assembly for "Tülip"




1. Release your stethoscope's locking ring by turning it counterclockwise.



2. Remove the old membrane from the ring.




3. Place me in the ring with my white side facing up and make sure I lie flat within the ring.




4. Tighten me with the ring onto the chest piece, so I fit tightly and my beautiful motif smiles at you.


Assembly for Littmann Classic III




1. Remove the old membrane from your stethoscope.




2. Take a matching ring and press it a few times in the palm of your hand. The movement and heat make the ring more flexible and assembly is easier.



3. Now put me about a quarter of the way into the ring. Don't try to insert me completely into the ring straight away. That could damage my sensitive body.



4. Now hold me between your thumb and forefinger and gradually pull me into the ring, always pulling up a small piece of the ring and letting me snap into place. Repeat this all around until I am completely in the ring.



5. Now you can mount me on the chest piece of the stethoscope as usual. Make sure my beautiful motif is facing up.
If I'm already in the ring when I arrive, just follow this last step.

Please test the functionality of your stethoscope after each replacement!

Cleaning & Disinfection

Clean and disinfect me regularly. This is of great importance – it serves both to protect the patient, the user and third parties, but also to maintain my quality.

I can tolerate ISO alcohol just like conventional stethoscopes-membranes. Clean my surface with a smooth cloth, dampened with ISO alcohol, to remove dust and dirt.

Despite extensive measures by my manufacturer to

maintain the vibrant color of my design, environmental factors can affect the longevity of the motif. Therefore, please replace me after 30 days of use or if I show discoloration or damage.

Warranty

If you use me as intended and follow these instructions for use, the warranty for manufacturing and material defects is two years, starting from the date of sale.

Obvious misuse and accidental damage are excluded. Cosmetic damage, such as scratches on the surface, are also excluded from the warranty.

Disposal


Please only dispose of me in accordance with local / regional / international guidelines.

Manufacturer


DocCheck Shop GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Cologne, Germany
doccheckshop.com

Littmann® and Classic III™ are registered trademarks of 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, USA and are in no way affiliated with DocCheck Shop GmbH.

Explanation of symbols

 Medical device


 CE mark


 Manufacturer data (address)

 Production date

 Article number


 Batch

 No latex / natural rubber content

 My hero
doccheck.com

Copper

Manuel de l'utilisateur



pour
DocCheck "Tulip"
Littmann® Classic III™

Mon utilisation


Tu veux transformer ton stéthoscope en une pièce accrocheuse et colorée ? Ensuite, remplace la membrane standard de ton stéthoscope par moi et tu auras immédiatement apporté une mise à jour élégante à ton stéthoscope.

Veuillez noter que je ne conviens pas à tous les stéthoscopes. Utilise-moi uniquement avec les modèles de stéthoscope indiqués sur l'emballage.


Utilisation inappropriée

Si tu m'utilises d'une autre manière que celle décrite dans ce mode d'emploi, cela ne correspondra pas à mon objectif. Mon fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation. Dans ce cas, c'est toi, l'utilisateur, qui assume seul le risque. Sois prudent s'il te plait.


Montage pour "Tulip"




Desserre la bague de verrouillage du stéthoscope en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Retire l'ancienne membrane du bague de verrouillage.




Place-moi dans la bague de verrouillage à ce que mon côté blanc te fasse face et que je repose à plat dans la bague.




Tourne-moi avec la bague de verrouillage contre la poitrine pour qu'elle soit bien en place et que mon beau motif te sourie.


Montage pour Littmann Classic III




Retire l'ancienne membrane de ton stéthoscope.




Prenez un anneau adapté et pressez-le plusieurs fois dans la paume de votre main. Le mouvement et la chaleur rendent l'anneau plus flexible et facilitent le montage.



3. Maintenant, placez-moi environ au quart dans l'anneau. N'essayez pas de me mettre tout entier dans l'anneau pour le moment. Cela pourrait endommager mon corps sensible.



4. Maintenant, tenez-moi entre le pouce et l'index et tirez-moi progressivement dans l'anneau, en soulevant toujours un petit morceau de l'anneau et en me laissant m'y emboîter jusqu'à ce que je sois complètement dans l'anneau.



5. Maintenant, vous pouvez me monter sur le pavillon du stéthoscope de la manière habituelle. Assure-toi que le côté imprimé avec le motif soit orienté vers le haut.

Si je suis déjà sur le ring quand j'arrive, il suffit de suivre cette dernière étape.

Veuillez tester la fonctionnalité de votre stéthoscope à chaque changement !

Nettoyage & désinfection

Nettoie-moi et désinfecte-moi régulièrement. C'est très important: cela sert à la fois à protéger le patient, l'utilisateur et les tiers, mais aussi à préserver ma qualité.

Je peux tolérer l'alcool isopropylique, comme les membranes de stéthoscope classiques. Nettoyez ma surface avec un chiffon doux que vous aurez

préalablement humidifié avec de l'alcool isopropylique pour enlever la poussière et la saleté.

Malgré les mesures exhaustives prises par mon fabricant pour préserver la couleur éclatante de mon motif, les influences environnementales peuvent affecter la longévité du motif. Remplace-moi donc après 30 jours d'utilisation ou si je présente des décolorations ou des dommages.

Garantie

La garantie pour l'ensemble du produit est annulée en cas d'utilisation de pièces de rechange qui n'ont pas été achetées dans la boutique DocCheck.

Si tu m'utilises conformément à l'usage prévu et que tu respectes ce mode d'emploi, la garantie pour les défauts de fabrication et de matériaux est de deux ans, à compter de la date d'achat.

Une mauvaise utilisation apparente et des dommages accidentels sont exclus de la garantie. Les dommages esthétiques, tels que les rayures sur la surface, sont également exclus de la garantie.

Mise au rebut

Merci de bien toujours respecter les directives locales, régionales et internationales pour ma mise au rebut.


Fabricant


DocCheck Shop GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Cologne, Allemagne
doccheckshop.fr


Littmann® et Classic III™ sont des marques déposées de 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, USA et ne sont en aucun cas affiliées à DocCheck Shop GmbH.


Explication des symboles

 Produit médical


 Marque CE


 Données du fabricant (adresse)

 Date de production

 Numéro d'article


 Lot

 Aucune teneur en latex / caoutchouc naturel

 Mon héros
doccheck.com

Copper

Manual de usuario



para
DocCheck "Tülip"
Littmann® Classic III™

Mi propósito


¿Quieres convertir tu estetoscopio en una llamativa pieza llena de colores? Entonces, reemplaza la membrana estándar de tu estetoscopio por mí y habrás dado a tu estetoscopio una actualización de moda.

Por favor, ten en cuenta que no soy adecuado para todos los estetoscopios. Úsame solo con los modelos de estetoscopios indicados en el envase.


Uso inadecuado

Si me utilizas de otra forma que no sea la descrita en estas instrucciones, estarás contradiciendo mi uso previsto. Mi fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado. En este caso, solo tú eres el responsable de todo riesgo. Así que utilízame con cuidado.


Montaje para "Tülip"




1. Afloja el anillo girándolo en sentido antihorario.



2. Retire la antigua membrana del anillo de fijación.




3. Colócame en el anillo de manera que mi lado blanco esté hacia ti y esté completamente encajado en el anillo.




4. Gira el anillo de cierre junto conmigo firmemente en la pieza torácica, asegurándote de que esté bien ajustado y mi bello motivo te mire.


Montaje para Littmann Classic III




1. Remueva la membrana antigua de su estetoscopio.




2. Coje un anillo adecuado y comprímelo un par de veces en la palma de la mano. Con el movimiento y el calor el anillo se vuelve más flexible y se facilita el montaje.



3. Inserta más o menos un 1/4 en el anillo. No intentes colocarme por completo en el anillo, porque podrías dañar mi sensible cuerpo.



4. Sujétame entre el pulgar y el índice, y colócame poco a poco en el anillo, levantando pequeños segmentos del anillo e insertándome dentro hasta que esté completamente dentro del anillo.



5. Ahora puedes montar la pieza torácica del estetoscopio como de costumbre. Asegúrate de que el lado impreso con el diseño esté orientado hacia arriba.

Si cuando llegue ya estoy en el ring, sigue este último paso.

¡Por favor, verifica la funcionalidad de tu estetoscopio después de cada cambio!

Limpieza y desinfección

Límpiame y desinfectame con regularidad. Esto es de gran importancia, ya que sirve tanto para proteger al paciente, al usuario y a terceros como para mantener mi calidad.

Puedo tolerar el alcohol ISO al igual que las membranas de estetoscopio convencionales. Limpia mi superficie con un paño suave previamente humedecido con alcohol ISO para quitar el polvo y la suciedad.

A pesar de las extensas medidas tomadas por mi fabricante para conservar el color brillante de mi diseño, los factores ambientales pueden afectar la durabilidad del motivo. Por lo tanto, cámbiame después de 30 días de uso o si muestro alguna decoloración o daño.

Garantía

Si me utilizas conforme a lo previsto y sigues estas instrucciones de uso, la garantía por defectos de fabricación y materiales es de dos años, a partir de la fecha de venta. Quedan excluidos el mal uso evidente y los daños accidentales. También quedan excluidos de la garantía los daños estéticos, como arañazos en la superficie.

Desecho

Deséchame únicamente de acuerdo con las normativas locales, regionales o internacionales.

Fabricante

DocCheck Shop GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Colonia, Alemania
doccheckshop.com

Littmann® y Classic III™ son marcas comerciales registradas de 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, EE. UU., y no están afiliadas de ninguna manera con DocCheck Shop GmbH.

Explicación de símbolos

Producto médico

Marca CE

Datos del fabricante (dirección)

Fecha de producción

Número de artículo


Lote

Sin contenido de látex/caucho natural

Mi héroe
doccheck.com

Copper

Manuale d'uso

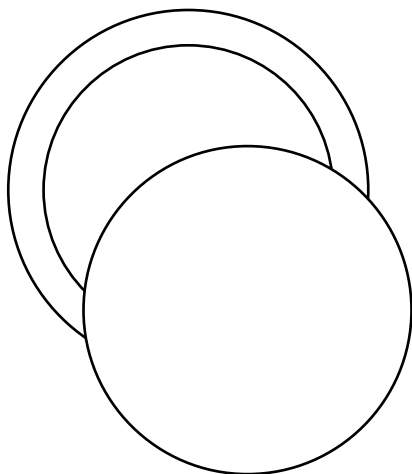

per

DocCheck "Tülip"

Littmann® Classic III™

La mia destinazione d'uso


Vuoi trasformare il tuo stetoscopio in un'attrazione colorata? Allora sostituisci la membrana standard del tuo stetoscopio con me e avrai dato al tuo strumento un moderno aggiornamento di stile.

Per favore, tieni presente che non sono adatto a tutti gli stetoscopi. Utilizzami solamente con i modelli di stetoscopio indicati sulla confezione.


Uso improprio

Se mi applichi in modo diverso da come descritto in questo manuale, ciò non è conforme al mio scopo. Il mio produttore non è responsabile per danni derivanti da un uso non conforme alla mia destinazione d'uso. In questo caso, il rischio è solo dell'utente, quindi tuo. Presta quindi attenzione!


Montaggio per "Tülip"




1. Allenta l'anello di chiusura dello stetoscopio ruotandolo in senso antiorario.



2. Rimuovi la vecchia membrana dall'anello di bloccaggio.




3. Posizionami nell'anello in modo che il mio lato bianco sia rivolto verso di te e che sia aderente all'anello.




4. Girare me con l'anello di bloccaggio stretto contro la testina in modo che sia saldamente in posizione e il mio bel motivo vi sorrida.


Montaggio per Littmann Classic III




1. Rimuovi la vecchia membrana dal tuo stetoscopio.




2. Prendi un anello adatto e stringilo un paio di volte nel palmo della mano. Il movimento e il calore rendono l'anello più flessibile e più facile da montare.



3. Ora mettimi per circa 1/4 nell'anello. Non cercare subito di mettermi completamente nell'anello: potresti danneggiare il mio corpo sensibile.



4. Ora tienimi tra il pollice e l'indice e inseriscimi a poco a poco nell'anello, tirando sempre su un pezzetto dell'anello e facendomi scattare in posizione. Ripeti tutto finché non sarò completamente nell'anello.



5. Ora puoi montarmi sulla testina dello stetoscopio come al solito. Assicurati che il lato stampato con il motivo sia rivolto verso l'alto. .
Se quando arrivo sono già sul ring, seguite solamente quest'ultimo passo.

Per favore, testa la funzionalità del tuo stetoscopio dopo ogni cambio!

Pulizia e disinfezione

Puliscimi e disinfettami regolarmente. Questo è molto importante: serve sia a proteggere il paziente, l'utente e terzi, ma anche a preservare la mia qualità.

Posso tollerare l'alcol ISO proprio come i diaframmi degli stetoscopi convenzionali. Pulisci la mia superficie con un panno liscio precedentemente inumidito con alcool ISO per rimuovere polvere e impurità.

Nonostante le ampie misure adottate dal mio

produttore per preservare il colore brillante del mio motivo, le influenze ambientali possono influenzare la longevità del motivo. Pertanto, si prega di cambiarmi dopo 30 giorni di utilizzo o se presento scolorimenti o danni.

Garanzia

Se mi usi in modo conforme alla mia destinazione d'uso e segui queste istruzioni per l'uso, la garanzia per difetti di produzione e materiali è di due anni, a partire dalla data di vendita. Evidenti abusi e danni accidentali sono esclusi. Danni estetici, come graffi sulla superficie, sono anch'essi esclusi dalla garanzia.

Smaltimento


Per favore, smaltiscimi solo in conformità con le linee guida locali/regionali/internazionali.


Produttore


DocCheck Shop GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Colonia, Germania
doccheckshop.com


Littmann® e Classic III™ sono marchi registrati di 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, USA e non è in alcun modo affiliato con DocCheck Shop GmbH.


Spiegazione dei simboli

 Dispositivo medico

 Marcatura CE


 Dati del produttore (indirizzo)

 Data di produzione

 Codice articolo


 Lotto

 Privo di lattice/contiene gomma naturale

 Il mio eroe
doccheck.com

Copper

Handleiding



voor

DocCheck "Tulip"

Littmann® Classic III™

Mijn beoogde gebruik


Wil je je stethoscoop transformeren in een kleurrijk opvallend item? Vervang dan het standaardmembraan van je stethoscoop door mij en je hebt je stethoscoop een modieuze upgrade gegeven.

Let erop dat ik niet geschikt ben voor elke stethoscoop. Gebruik me alleen met de stethoscoop-modellen die op de verpakking zijn vermeld.


Ongeschikte toepassing

Als je me anders gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, is dat niet mijn bedoeling. Mijn fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Het risico is in dit geval alleen voor jou, de gebruiker. Dus wees voorzichtig!


Montage voor "Tulip"




1. Ontgrendel de borgring van je stethoscoop door deze tegen de klok mee te draaien.



2. Haal de oude membraan uit de borgring.




3. Plaats mij zo in de ring dat mijn witte kant naar jou gericht is en ik gelijkmatig in de ring ligt.




4. Draai mij samen met de borgring stevig aan het borststuk, zodat ik goed aansluit en mijn mooie motief naar je lacht.


Montage voor Littmann Classic III




1. Verwijder de oude membraan van je stethoscoop.




2. Neem een passende ring en druk deze een paar keer samen in de palm van je hand. De beweging en warmte maken de ring flexibeler en gemakkelijker te monteren.



3. Plaats me nu ongeveer 1/4 in de ring. Probeer me niet meteen volledig in te ring te klemmen. Dat zou mijn gevoelige lichaam kunnen beschadigen.



4. Houd me nu tussen je duim en wijsvinger en trek me geleidelijk in de ring, waarbij je altijd een klein stukje van de ring omhoog trekt en me op zijn plaats laat klikken. Herhaal dit rondom totdat ik helemaal in de ring zit.



5. Nu kan je mij zoals gewoonlijk op het borststuk van de stethoscoop monteren. Zorg ervoor dat de bedrukte zijde met het motief naar boven ligt. Als ik al in de ring ben als ik aankom, volg dan alleen deze laatste stap.

Test alsjeblieft de functionaliteit van je stethoscoop opnieuw na elke verandering!

Reiniging & desinfectie

Reinig en desinfecteer me regelmatig. Dit is van groot belang – het dient zowel de bescherming van de patiënt, de gebruiker en derden, maar ook om mijn kwaliteit te behouden.

Ik verdraag ISO-alcohol net zo goed als conventionele stethoscoopmembranen. Reinig mijn oppervlak met een gladde doek die je eerst hebt bevochtigd met ISO-alcohol om stof en vuil te verwijderen.

Ondanks uitgebreide maatregelen van mijn fabrikant om de levendige kleur van mijn motief te behouden, kunnen omgevingsinvloeden de duurzaamheid van het motief beïnvloeden. Vervang me daarom na 30 dagen gebruik of als ik verkleuringen of beschadigingen vertoon.

Garantie

Als je me gebruikt zoals bedoeld en deze gebruiksaanwijzing in acht neemt, bedraagt de garantie voor fabricage- en materiaalfouten twee jaar, te rekenen vanaf de verkoopdatum. Kennelijk verkeerd gebruik en accidentele schade zijn hiervan uitgesloten. Cosmetische schade, zoals krassen op het oppervlak, zijn ook uitgesloten van de garantie.

Verwijdering


Verwijder mij alsjeblieft alleen volgens de plaatselijke/regionale/internationale richtlijnen.


Fabrikant


DocCheck Shop GmbH
Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen, Duitsland
doccheckshop.nl

Littmann® en Classic III™ zijn gedeponeerde handelsmerken van de 3M™ Company, St. Paul, Minnesota, VS en zijn op geen enkele manier gelieerd aan DocCheck Shop GmbH.

Verklaring van symbolen

 Medisch product


 CE-markering

 Fabrikantgegevens (adres)

 Productiedatum

 Artikelnummer

 Partij

 Geen latex/natuurlijk rubbergehalte

 Mijn held
doccheck.com